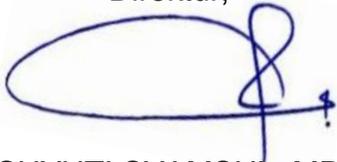


 <p><b>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</b> Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 <a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a> email : rsudpbun@gmail.com</p>	<b>PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI BAWAH DENGAN KONTRAS</b>		
	No. Dokumen: P/SPO/03/067	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

Pengertian	Pemeriksaan CT-Scan tungkai bawah dengan kontras adalah pemeriksaan tungkai bawah menggunakan peralatan CT-scan tanpa memakai media kontras untuk menghasilkan gambar radiografi.
Tujuan	Untuk memperlihatkan anatomi tungkai bawah dan jaringan sekitarnya.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana pemeriksaan adalah radiografer bersama dokter spesialis radiologi.</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang CT-Scan radiologi.</li> <li>3. Pemeriksaan dilakukan bila ada permintaan dari dokter.</li> <li>4. Pemeriksaan CT-Scan Tungkai bawah dengan kontras dilakukan menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- peralatan CT Scan dan printer.</li> <li>- Kontras media non ionik</li> <li>- Injektor</li> <li>- "tree way"</li> <li>- Abocath</li> </ul> </li> <li>5. Langkah-langkah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan peralatan, bahan dan berkas yang dibutuhkan.</li> <li>- Memanggil pasien.</li> <li>- Melakukan inform concern</li> <li>- Melakukan registrasi dan memilih protokol pemeriksaan dengan mengklik "<i>Tungkai bawah_contras</i>".</li> </ul> </li> </ol>

 <p><b>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</b> Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 <a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a> email : rsudpbun@gmail.com</p>	<b>PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI BAWAH DENGAN KONTRAS</b>		
	No. Dokumen: P/SPO/03/067	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memposisikan pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan.</li> <li>- Memposisikan obyek (tungkai bawah) dimana lampu indikator warna merah yang melintang setinggi 2 cm diatas ankle joint dan yang membujur sejajar tubuh.</li> <li>- Meminta pasien tidak bergerak dan mengikuti aba-aba selama pemeriksaan.</li> <li>- Membuat topogram</li> <li>- Mengatur range dengan garis awal mulai dari <i>genu</i> sampai ankle joint. Tebal irisan 5 mm.</li> <li>- Melakukan scanning dengan mengklik “<i>confirmasi</i>” lalu klik tombol “<i>move to scan</i>” lanjut klik “<i>start scan</i>”.</li> <li>- Menunggu proses scanning.</li> <li>- Membuat topogram</li> <li>- Mengatur range dengan garis awal mulai dari <i>genu</i> sampai ankle joint. Tebal irisan 5 mm.</li> <li>- Melakukan scanning dengan mengklik “<i>confirmasi</i>” lalu klik tombol “<i>move to scan</i>” lanjut klik “<i>start scan</i>”.</li> <li>- Lakukan test injektor</li> <li>- Masukkan media kontras dengan injektor bersamaan dengan klik tombol “<i>start scan</i>”</li> <li>- Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan.</li> <li>- Melakukan pengolahan dan rekontruksi gambar sesuai kebutuhan diagnosa.</li> <li>- Melakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi.</li> <li>- Menyerahkan hasil pemeriksaan CT-Scan sesuai prosedur.</li> </ul>
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap, IPSRS.